


# Matriz de Posicionamento Radiopaco (WPMX02)

A Matriz de Posicionamento Radiopaco WIPPE é indicada para procedimentos de estimulação, localização e bloqueio de nervos e articulações, especialmente fármacos, caso seja necessária a utilização durante o procedimento.

Possui indicação de uso para procedimentos nas regiões da coluna, quadril, ombros, joelhos, temporomandibular e pés, guiados por fluoroscopia, além de procedimentos de bloqueio de plexo lombar, cervical e toracolombar, mas não se limitando a estes.

Também podendo ser utilizada para tratamento intervencionista da dor e cirurgia da coluna vertebral.

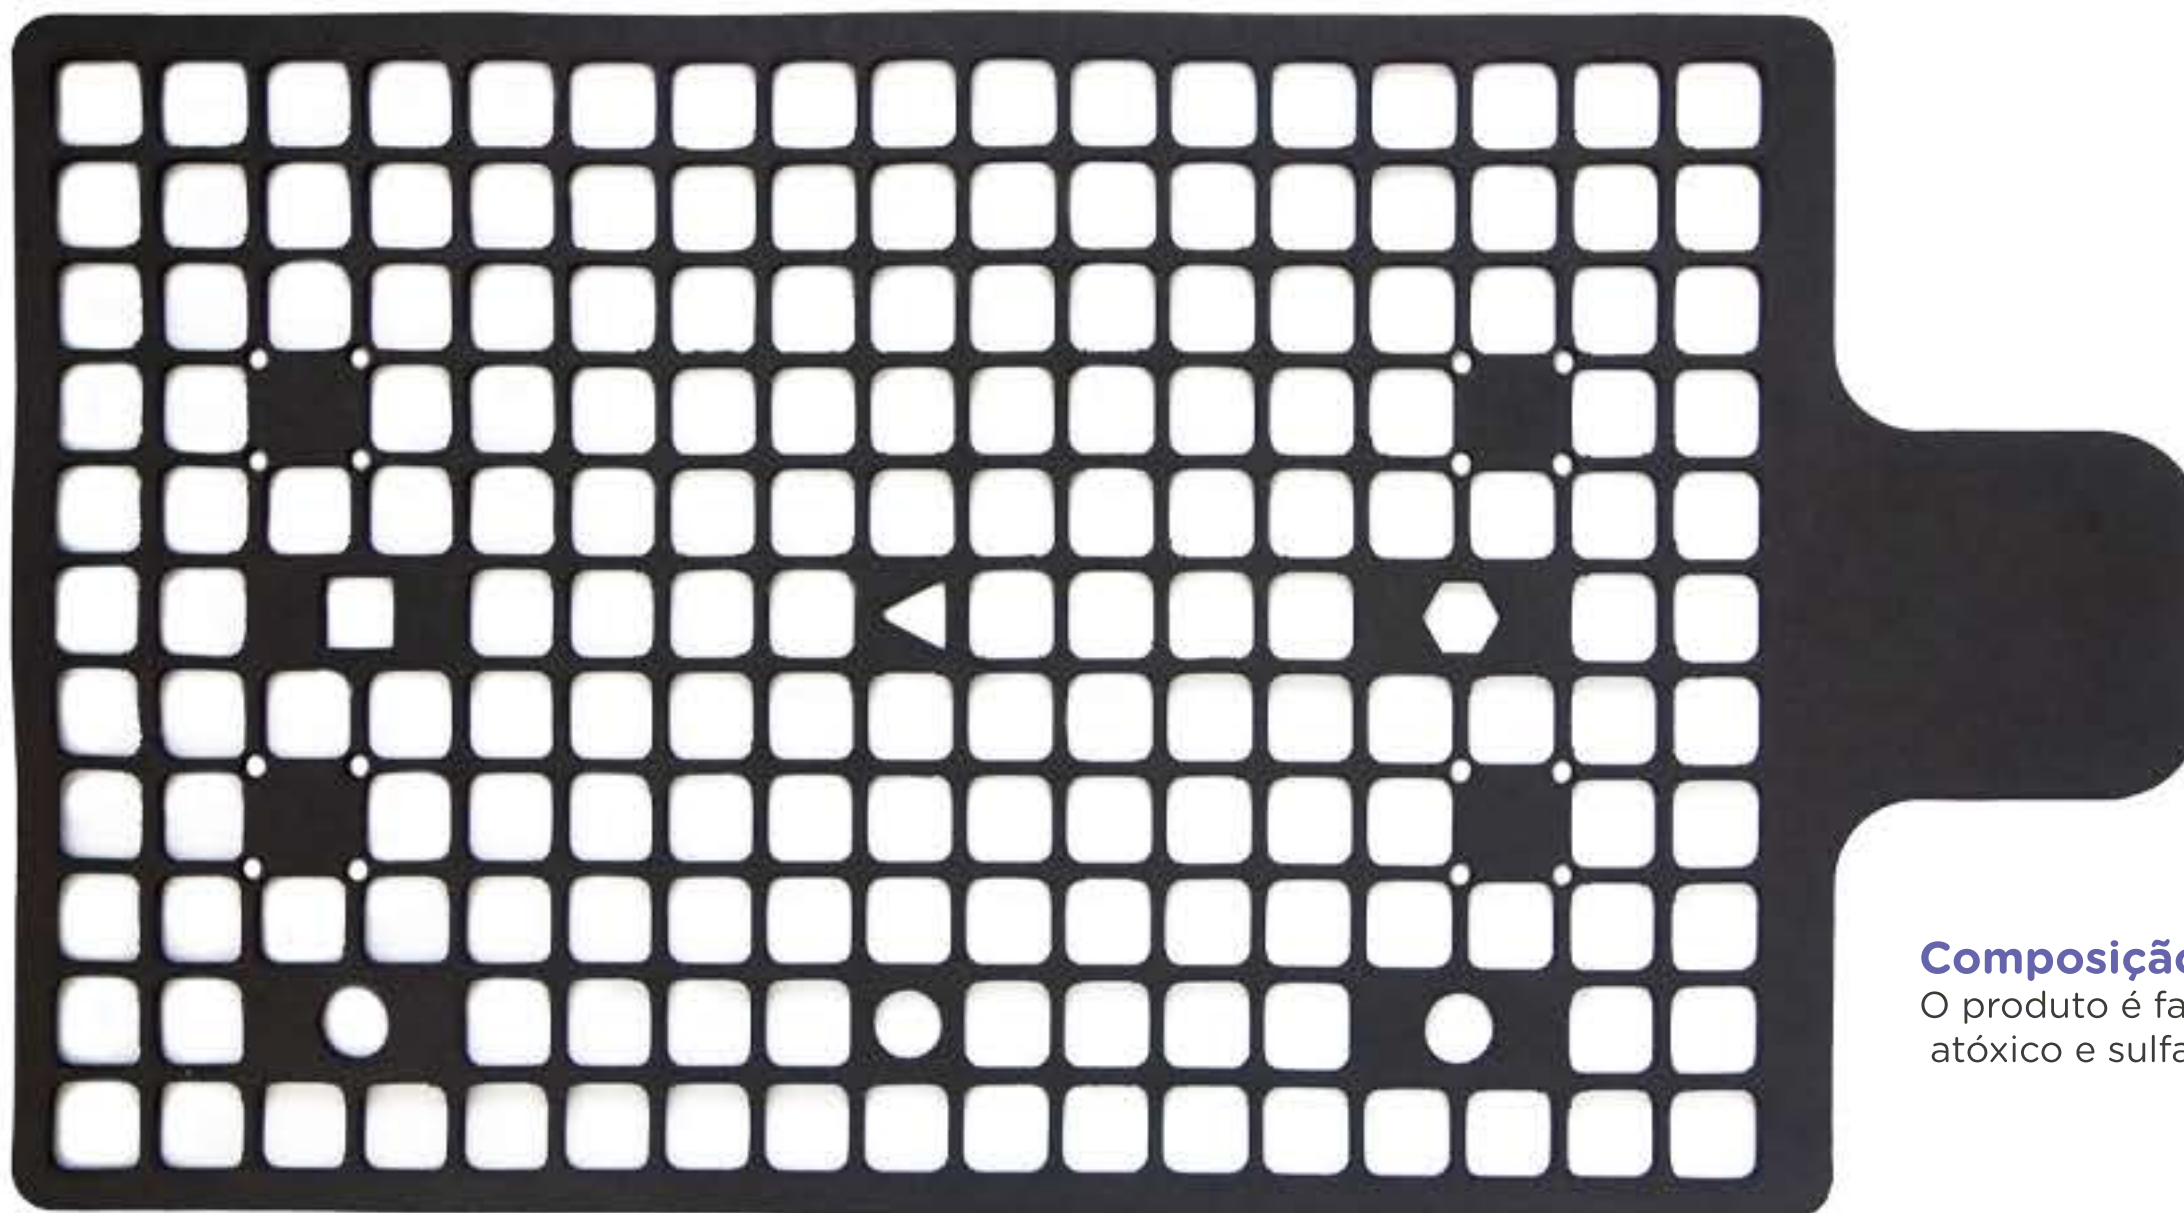

**Composição:**

O produto é fabricado em silicone atóxico e sulfato de bário.

PRODUTO ESTÉRIL.  
PRODUTO DE USO ÚNICO.  
REGISTRO ANVISA Nº 80743230083

